

Chambre de mesure QV-HFlow L130

Fiche technique DfrA8343616X

Chambre de mesure pour la mesure en continu de la conductivité dans l'eau ultrapure.

Caractéristiques

- Pour une installation d'un capteur NPT $\frac{3}{4}$ ",
Ex. Swansensor RC U
- Dimensions du capteur : Diamètre $\frac{1}{2}$ ", longueur
max. 89 mm
- Vanne à pointeau intégrée pour l'ajustement du
débit
- Débitmètre intégré
- Chambre de mesure en acier inoxydable 1.4404
(SS316L).

Contenu de la livraison

- Chambre de mesure QV-HFlow L130.
- Pièces de montage (vis M5, rondelles, écrous et
entretoise).
- Tubing de sortie (LD-PE) : 1.5 m

Conditions de l'échantillon


Conditions de température : de 0 à 50 °C
Pression d'entrée : max. 2 bar
Pression de sortie : atmosphérique
Débit d'échantillon : de 20 à 100 L/h

Raccordements de processus

Entrée : Raccord Swagelok avec filetage R $\frac{1}{8}$ " (ISO 7-1)
pour tube d'un diamètre extérieur de $\frac{1}{4}$ "
Sortie : adaptateur 8 mm Serto (PA) pour tube

Connexions électriques

Débitmètre : câble avec embouts
Utilisation avec les transmetteurs SWAN Rescon

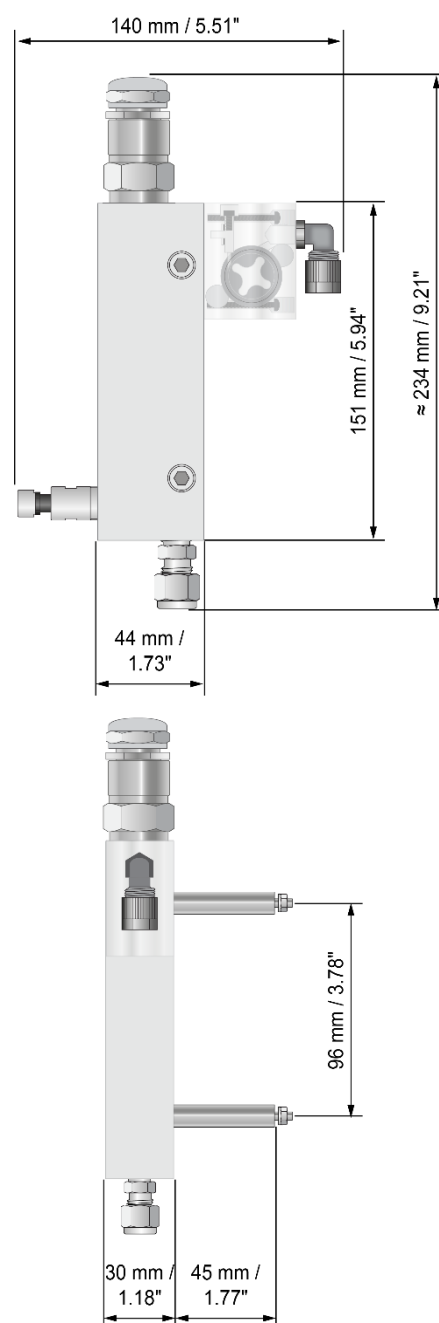

Réf. de commande: Chambre de mesure QV-HFlow L130		A-83.436.16
Longueur du câble du débitmètre :	Câble 1 m.....	1
	Câble 5 m.....	5
Accessoires	Pour tous les accessoires et détails, merci de consulter notre site web www.swan.ch . Swansensor RC U	A-87.322.2X0

